



Diagnostique Diagnóstico



MADE IN ITALY



ASA DENTAL
MAKE PEOPLE SMILE

Diagnostique Diagnóstico

Précelles pour Coton
Pinzas para Algodón y Curas



S0601-1
Set de 5 pièces Fig. 1 Flagg
Juego con 5 unidades Fig. 1 Flagg"



S0601-2
Set de 5 pièces Fig. 2 London College
Juego con 5 unidades Fig. 2 London College



S0601-3
Set de 5 pièces Fig. 3 Meriam
Juego con 5 unidades Fig. 3 Meriam



0601-1
Fig. 1
Flagg
cm. 15

0601-2
Fig. 2
London College
cm. 15

0601-3
Fig. 3
Meriam
cm. 16

0601-4
Fig. 4
Perry
cm. 13

0601-5
Fig. 5
Perry
cm. 13

0600-4
Fig. 4
Perry
cm. 13



Précelles pour Coton
Pinzas para Algodón y Curas



0600-2
Précelle universelle London College
Pinzas universal London College



0600-2
Fig. 2
College
cm. 16

0600-3
Fig. 3
cm. 16

0600-17
Fig. 17
cm. 16

0600-18
Fig. 18
cm. 16

0600-19
Fig. 19
cm. 16,5

Diagnostique Diagnóstico

Précelles à Marquer


Pinzas para Marcar las Bolsas



0650-1

Précelle à marquer Goldman-Fox

Pinza para marcar las bolsas Goldman-Fox

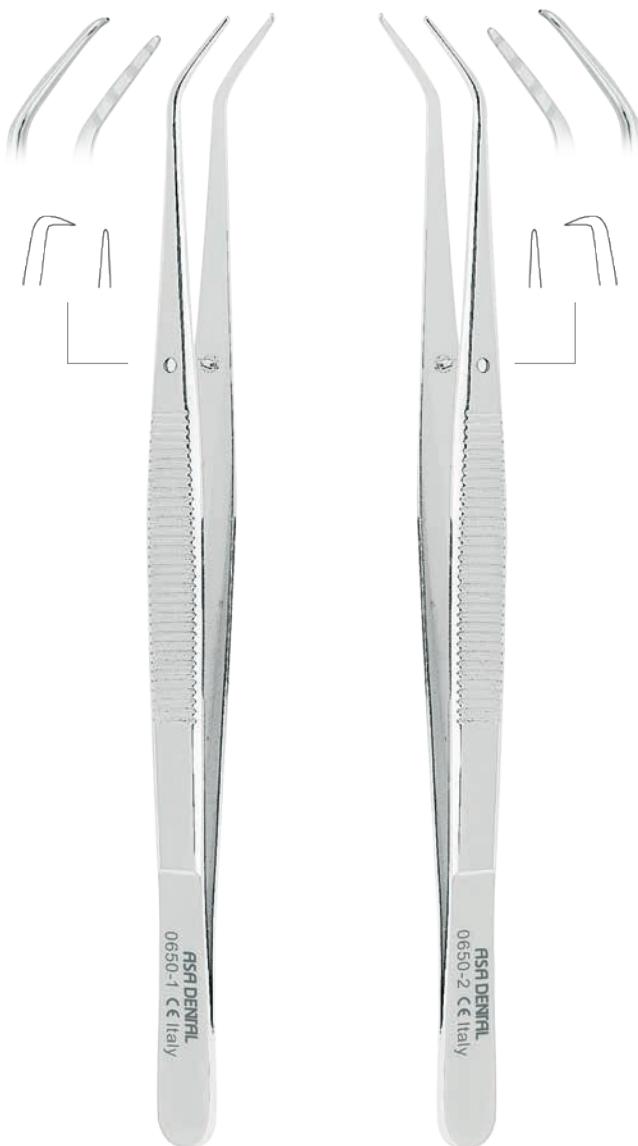

0650-1
Fig. 1
(Crane-Kaplan)
Goldman-Fox
cm.15

0650-2
Fig. 2
(Crane-Kaplan)
Goldman-Fox
cm.15

Précelles pour Coton

Pinzas para Algodón y Curas



0602-2

Précelle
autofermantes

Pinza con cierre



0600-18L
Fig. 18L
Locking
cm. 16

0602-1
Fig. 1
cm.15

0602-2
Fig. 2
cm. 15

Sonde
Sondas

LEONARDO



ML0700-3R
Fig. 3R
Rhein

ML0700-6
Fig. 6

ML0700-8
Fig. 8


ML0700-9
Fig. 9

ML0700-17
Fig. 17

ML0700-23
Fig. 23


Sonde Double
Sonda Doble

LEONARDO

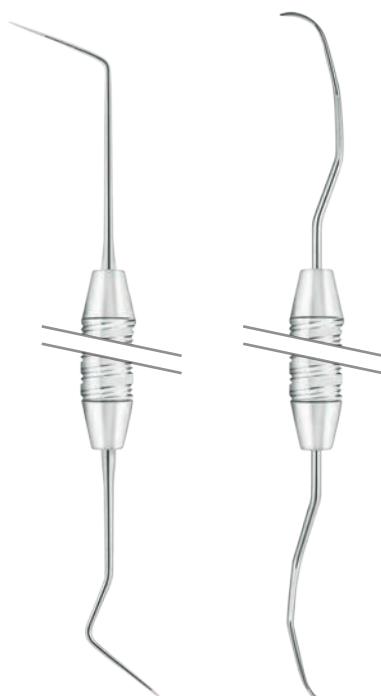

ML0704-6D9
Fig. 6/9

ML0704-11/12AF
Fig. 11/12AF

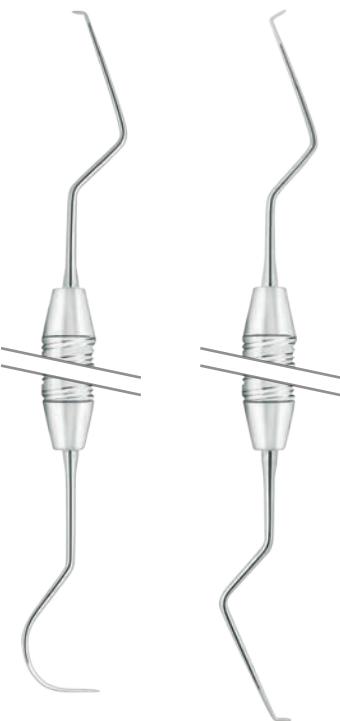

ML0704-23D1
Fig. 23/17

ML0704-6D2
Fig. 17/19

Explorateurs


Sondas con Mango Anatómico

**0700-23**
Fig. 23**0700-9**
Fig. 9**0700-10**
Fig. 10**0700-11**
Fig. 11**0700-12**
Fig. 12**0700-16**
Fig. 16**0700-17**
Fig. 17**0700-17A**
Fig. 17A


ASA DENTAL 0700-23 C € Italy

Explorateurs

Sondas con Mango Anatómico

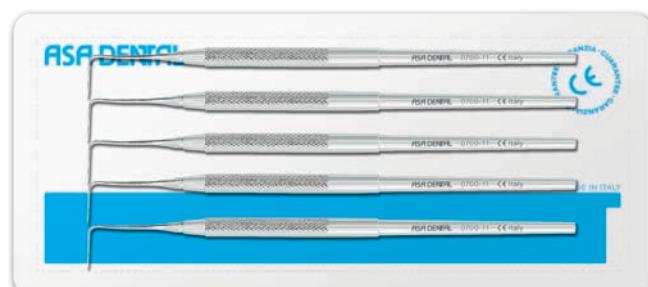**S0700-6**Set de 5 pièces Fig. 6
Juego con 5 unidades Fig. 6**S0700-9**Set de 5 pièces Fig. 9
Juego con 5 unidades Fig. 9**S0700-11**Set de 5 pièces Fig. 11
Juego con 5 unidades Fig. 11**S0700-16**Set de 5 pièces Fig. 16
Juego con 5 unidades Fig. 16

0700-23
Explorateur fig. 23
Sonda fig. 23

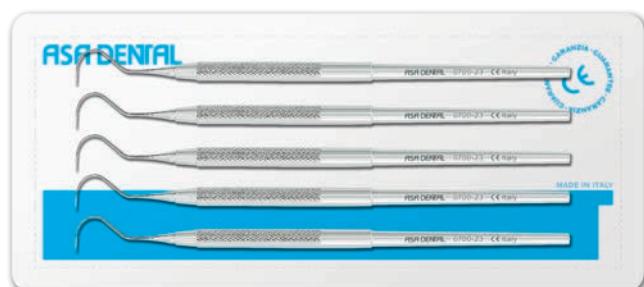**S0700-23**Set de 5 pièces Fig. 23
Juego con 5 unidades Fig. 23

Explorateurs
Sondas



ASA DENTAL 0701-23 CE Italy

0701-2
Fig. 2

0701-3
Fig. 3

0701-3A
Fig. 3A

0701-5
Fig. 5

0701-6
Fig. 6

0701-8
Fig. 8

0701-9
Fig. 9

0701-10
Fig. 10

0701-11
Fig. 11

0701-12
Fig. 12

0701-16
Fig. 16

0701-17
Fig. 17

0701-17A
Fig. 17A

Sondes Parodontales
Sondas para Periodoncia



0707L-GFW
Goldman-Fox
Williams

0708-1N
Fig. 1N
Nabers

0708-2N
Fig. 2N
Nabers

0708L-2N
Fig. 2N
Nabers



0707L-GFW

Sonde paradontale graduée avec deux pointes divers:

l'une à cône, (Williams), l'autre plate, (Goldman-Fox)

*Sonda periodontal milímetrada con dos puntas diferentes,
una conica (Williams), y otra plana (Goldman-Fox)*



MV0707-GFW
Goldman-Fox
Williams

MV0708-1N
Fig. 1N
Nabers

MV0708-2N
Fig. 2N
Nabers



MV0708-2N

Sonde paradontale Nabers n. 2, courbe pour mieux faciliter l'accès dans les poches gingivales

*Sonda Nabers n. 2 con curvatura redonda
para facilitar el acceso a la zona*

Explorateurs Doubles

Sondas Dobles

0704-11/12AF

Sonde pointe très longue et courbe, même modèle de la curette de Gracey 11/12AF, pour faciliter l'accès dans les poches gingivales

Sonda con punta muy larca y curvada con el mismo diseño de la cureta Gracey 11/12 AF para un facil acceso a la zona



0704-23D1
Fig. 23/17


0704-23D2
Fig. 23/17A

0709-2
Fig. 2

0709-2A
Fig. 2A

0709-3
Fig. 3

Explorateurs à canaux Sondas para canales

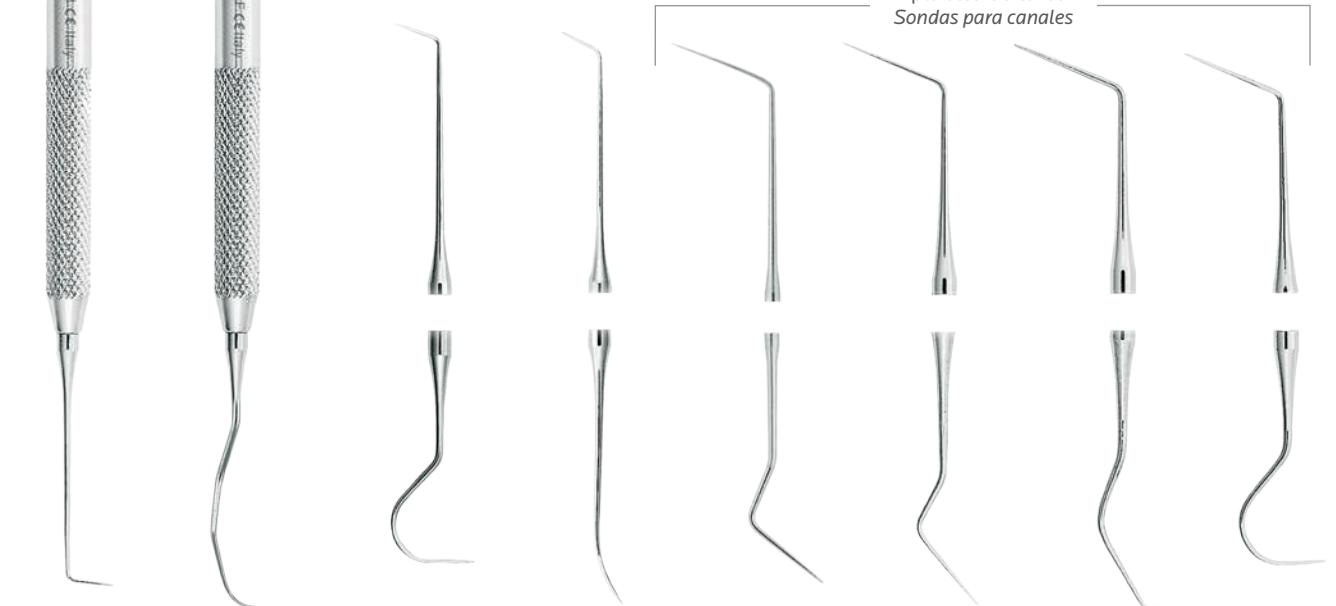

0704-UT1
Fig. UT 1/2
Cattoni

0704-11/12AF
Fig. 11/12AF

0704-16D1
Fig. 16/23

0704-16D2
Fig. 16/3

0704-6D9
Fig. 6/9

0710-6D1
Fig. 6/1

0710-6D2
Fig. 6/17

0710-6D3
Fig. 6/23

Explorateurs Doubles
Sondas Dobles

**MV0710-6D1**

Explorateur cherche canaux ou endodontique
Sonda dobla para canales o para endodoncia



MV0704-UT1
Fig. UT 1/2
Cattoni


MV0704-23D1
Fig. 23/17



MV0704-23D2
Fig. 23/17A




MV0709-2
Fig. 2



MV0709-2A
Fig. 2A



MV0709-3
Fig. 3

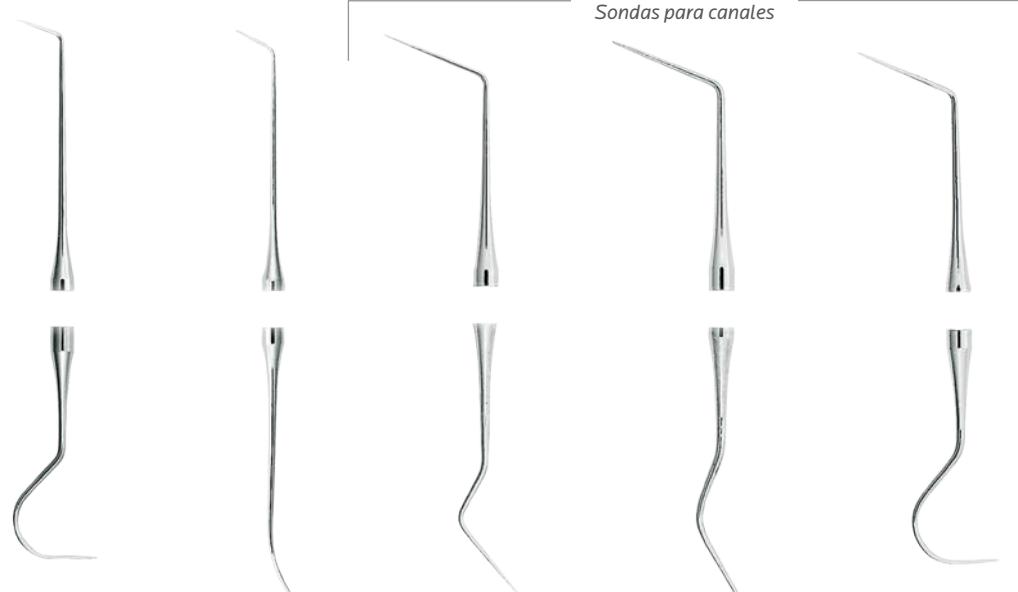

MV0710-6D1
Fig. 6/1

MV0710-6D2
Fig. 6/17

MV0710-6D3
Fig. 6/23

Diagnostique Diagnóstico


Sondes Parodontales Graduées
Sondas Calibradas para Periodoncia

~~LASER~~
SYSTEM

0702L-12S

Sonde CP-12S OMS avec millimétrage coloré
pour le contrôle des cavités des canaux

Sonda CP-S OMS con bandas coloreadas
para medir profundidad de bolsa

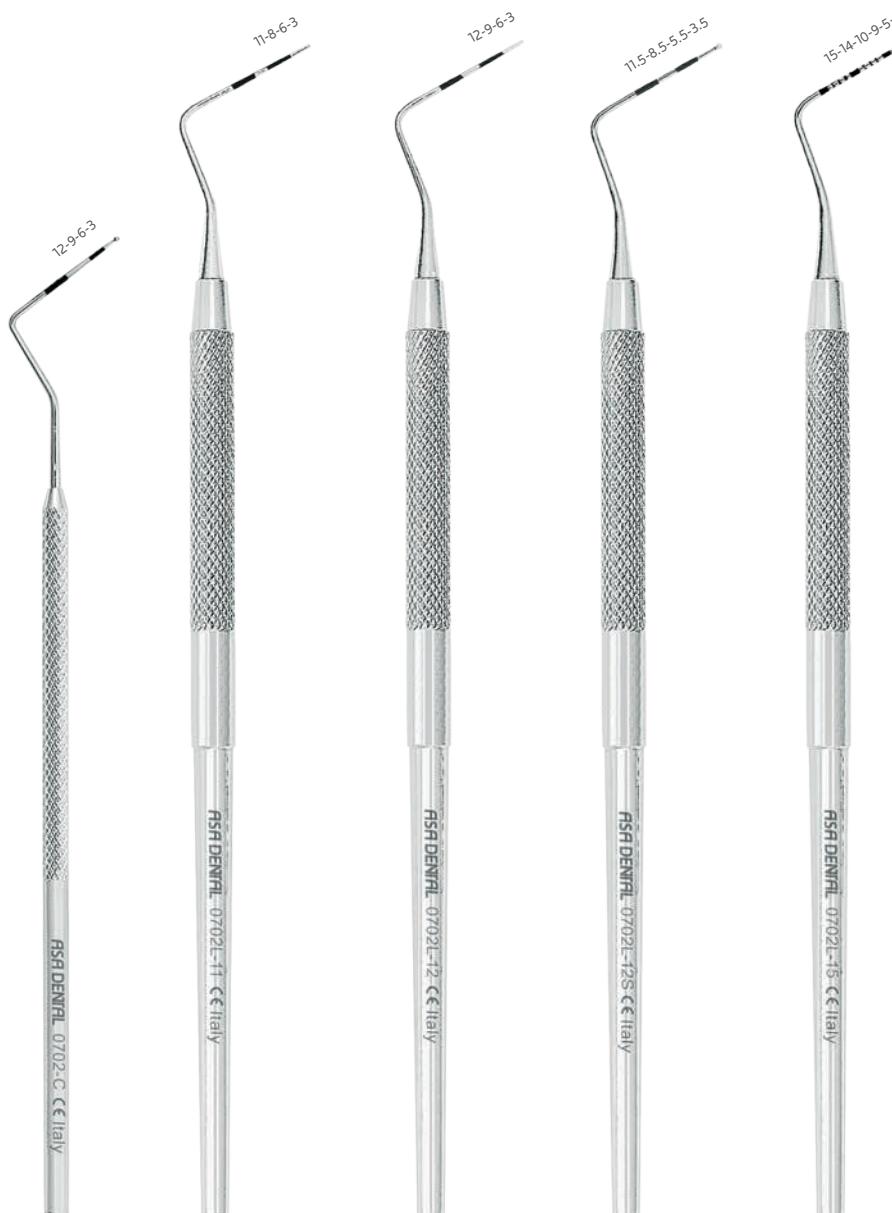

0702-C
CP-C

0702L-11
CP-11

0702L-12
CP-12

0702L-12S
CP-12S
O.M.S.

0702L-15
CP-15



- Nouveau procédé de production
- Gravure au laser
- Évite les pertes de vernis dans les poches et dans la cavité des canaux
- Permet un millimétrage indélébile
- Gravures anti-reflet
- Cela n'affaiblit pas la pointe, évite la possibilité de ruptures
- Nuevo proceso de fabricación
- Marcado con láser
- No más puntas descascarilladas
- Marcado en profundidad antideslumbrante
- Puntas con la máxima resistencia para evitar posibles roturas

Sondes Parodontales Graduées
Sondas Calibradas para Periodoncia

~~LASER
SYSTEM~~



0703L-1
Williams



0703L-2
Merrit A



0703L-3
Merrit B

Pointes Plates
Punta Plana

0703L-1
Sonde parodontale
graduée Williams
Sonda calibrada para
periodoncia Williams



10-9-8-7-5-3-2-1

10-9-8-7-5-3-2-1

10-9-8-7-5-3-2-1

10-9-8-7-5-3-2-1

10-9-8-7-5-3-2-1

10-9-8-7-5-3-2-1

10-9-8-7-5-3-2-1

10-9-8-7-5-3-2-1



ASA DENTAL 0703L-5 CE Italy



ASA DENTAL 0703L-6 CE Italy

0703L-6
26 G

Sondes-Explorateurs

Sondas Combinadas - Sondas Calibradas

LASER
SYSTEM

Pointes Plates
Punta Plana



0705L-23UM
Fig. 23
University
of Michigan



0705L-23W
Fig. 23
Williams



Pointes Plates
Punta Plana



0705L-17GF
Fig. 17
Goldman-Fox



0705L-17UM
Fig. 17
University of
Michigan



0705L-17W
Fig. 17
Williams



ASA DENTAL 0705L-23UM 0705L-23W 0705L-17GF 0705L-17UM 0705L-17W

Pointes Plates
Punta Plana

10-9-8-7-5-3-2-1

0705L-23GF
Fig. 23
Goldman-Fox

10-9-8-7-5-3-2-1

10-9-8-7-5-3-2-1

0705L-3GF
Fig. 3
Goldman-Fox

10-9-8-7-5-3-2-1

10-9-8-7-5-3-2-1

0705L-16GF
Fig. 16
Goldman-Fox

10-9-8-7-5-3-2-1

10-9-8-7-5-3-2-1

10-9-8-7-5-3-2-1

0705L-16W
Fig. 16
Williams

11-8-6-3

11-8-6-3

11-8-6-3

0706L-2311
Fig. 23/CP11

12-9-6-3



12-9-6-3

12-9-6-3



Sondes-Explorateurs

Sondas Combinadas - Sondas Calibradas

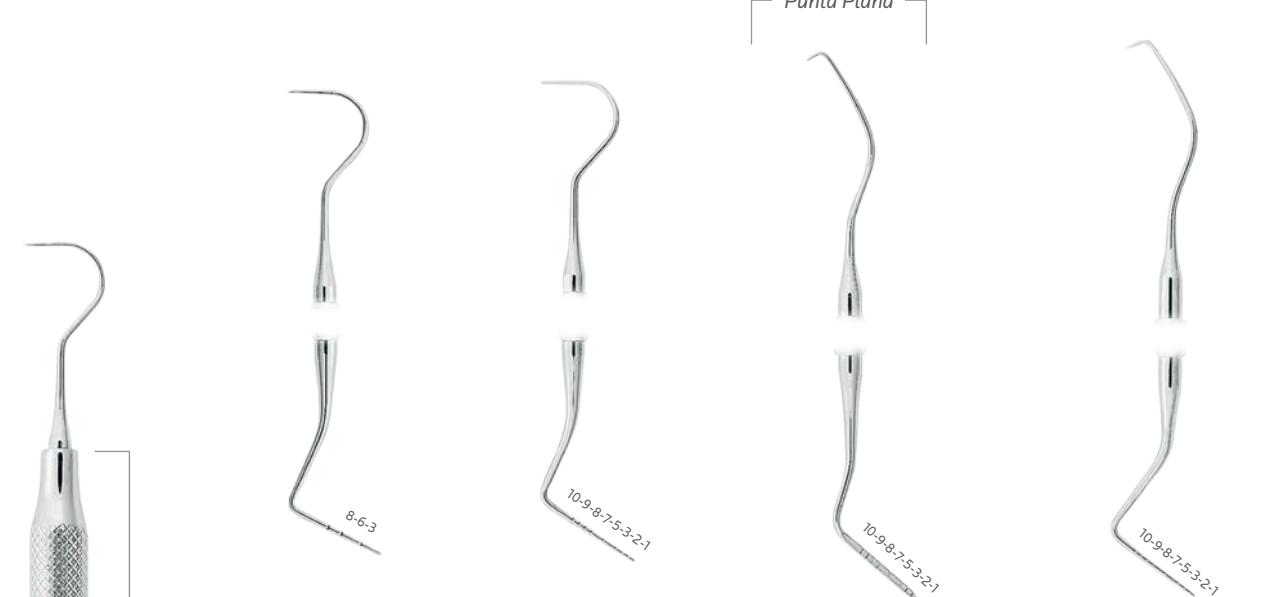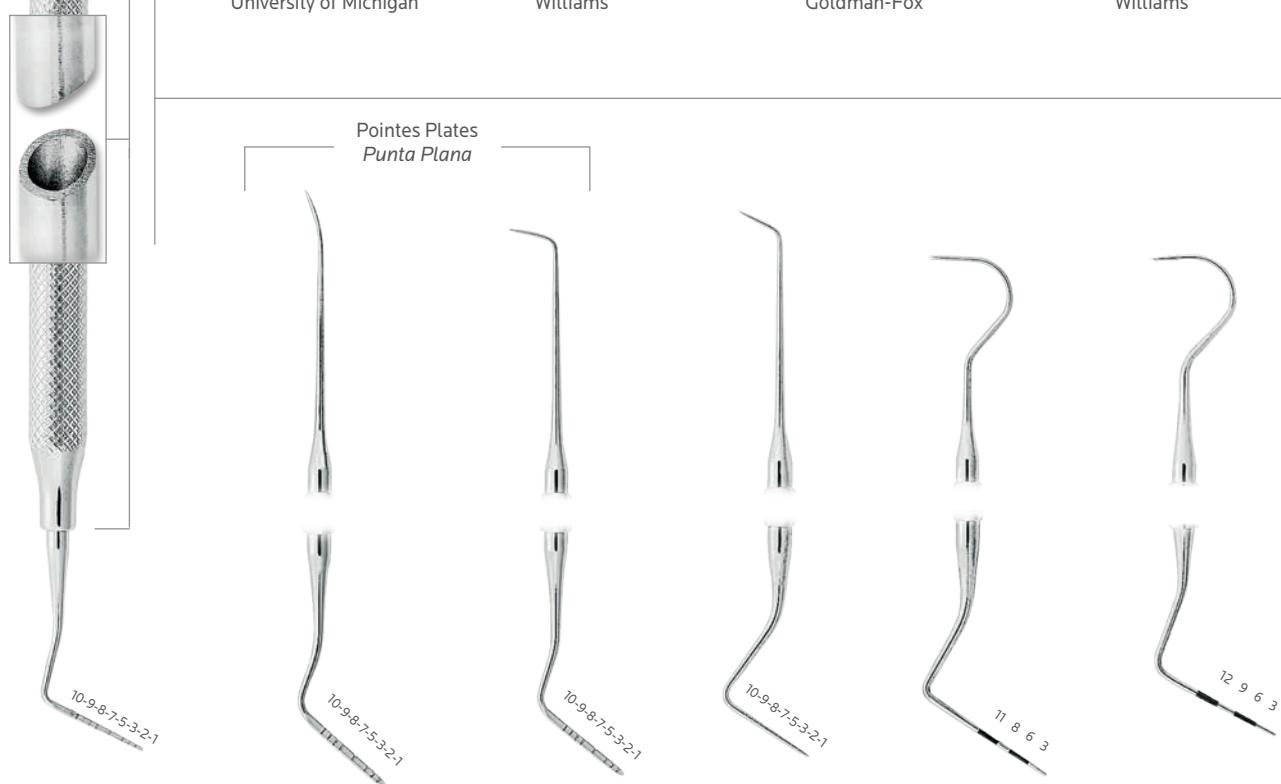Pointes Plates
Punta Plana**MV0705-23UM**
Fig. 23
University of Michigan**MV0705-23W**
Fig. 23
Williams**MV0705-17GF**
Fig. 17
Goldman-Fox**MV0705-17W**
Fig. 17
WilliamsPointes Plates
Punta Plana**MV0705-23GF**
Fig. 23
Goldman-Fox**MV0705-3GF**
Fig. 3
Goldman-Fox**MV0705-16GF**
Fig. 16
Goldman-Fox**MV0705-16W**
Fig. 16
Williams**MV0706-2311**
Fig. 23/CP11**MV0706-2312**
Fig. 23/CP12

Instruments à Endodontie

Instrumentos para Tratamientos de los Nervios

**0800-1**Spreader pour condensation latérale de la gutta
Espaciador para condensacion lateral**0800-1**
Fig. 1
Spreader**0800-2**
Fig. 2
Spreader**0800-3**
Fig. 3
Spreader**0800-4**
Fig. 4
Spreader**0800-5**
Fig. 5
Spreader**0800-6**
Fig. 6
Spreader**0800-7**
Fig. 7
Spreader

Endodontie
Endodoncia

LEONARDO

Sonde millimétrée parodontale
Sondas periodontales milímetradas



ML0702-0MS
Fig. 0MS

ML0705-23W
Fig. 23
Williams

Spreader
Espaciadores




ML0800-1
Fig. 1
Spreader

Fouloirs doubles pour canaux Pluggers/Spreaders
Obturadores dobles para canales Pluggers/Spreaders




ML0803-1
Spreader pour condensation latérale de la gutta
Espaciador para condensación lateral

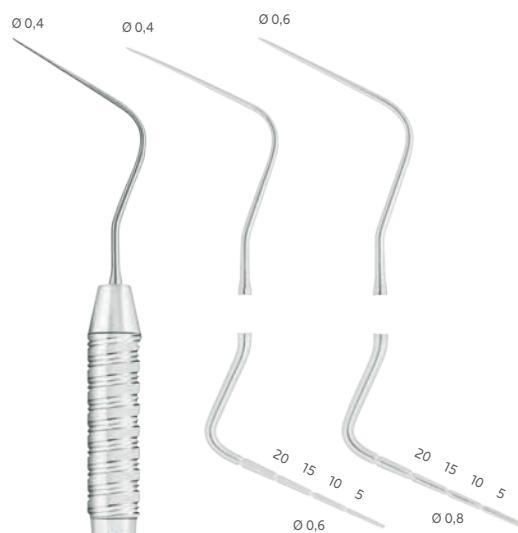

ML0803-2
Fig. 2
Machtou

ML0803-3
Fig. 3
Machtou

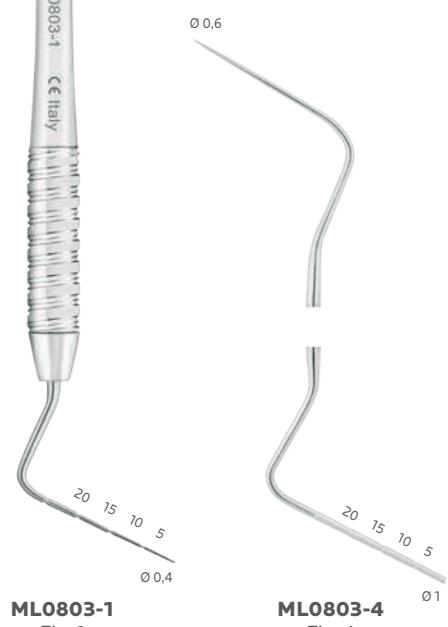

ML0803-1
Fig. 1
Machtou

ML0803-4
Fig. 4
Machtou

Endodontie
Endodoncia


LEONARDO



ML0802-2

Spreader pour condensation verticale de la gutta
Obturador para condensacion vertical

Fouloirs à endodontie pour canaux
Obturadores para canales

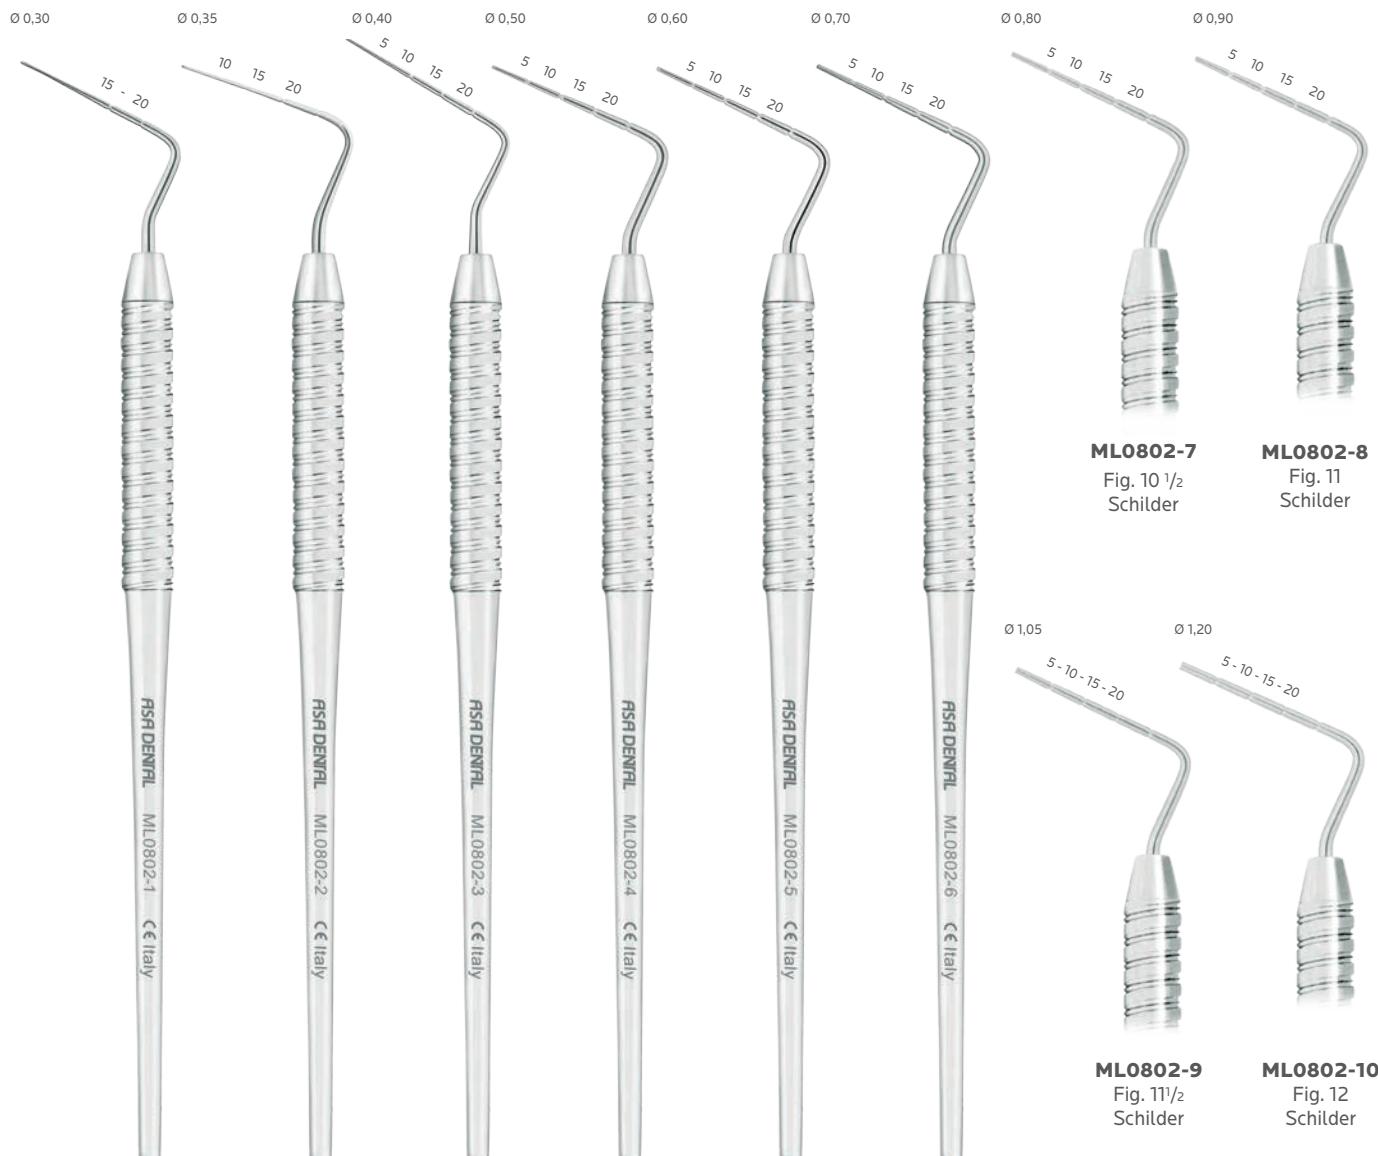

ML0802-1
Fig. 7½
Schilder

ML0802-2
Fig. 8
Schilder

ML0802-3
Fig. 8½
Schilder

ML0802-4
Fig. 9
Schilder

ML0802-5
Fig. 9½
Schilder

ML0802-6
Fig. 10
Schilder


ML0802-9
Fig. 11½
Schilder

ML0802-10
Fig. 12
Schilder



Instruments à Endodontie
Instrumentos para Endodoncia

LASER
SYSTEM

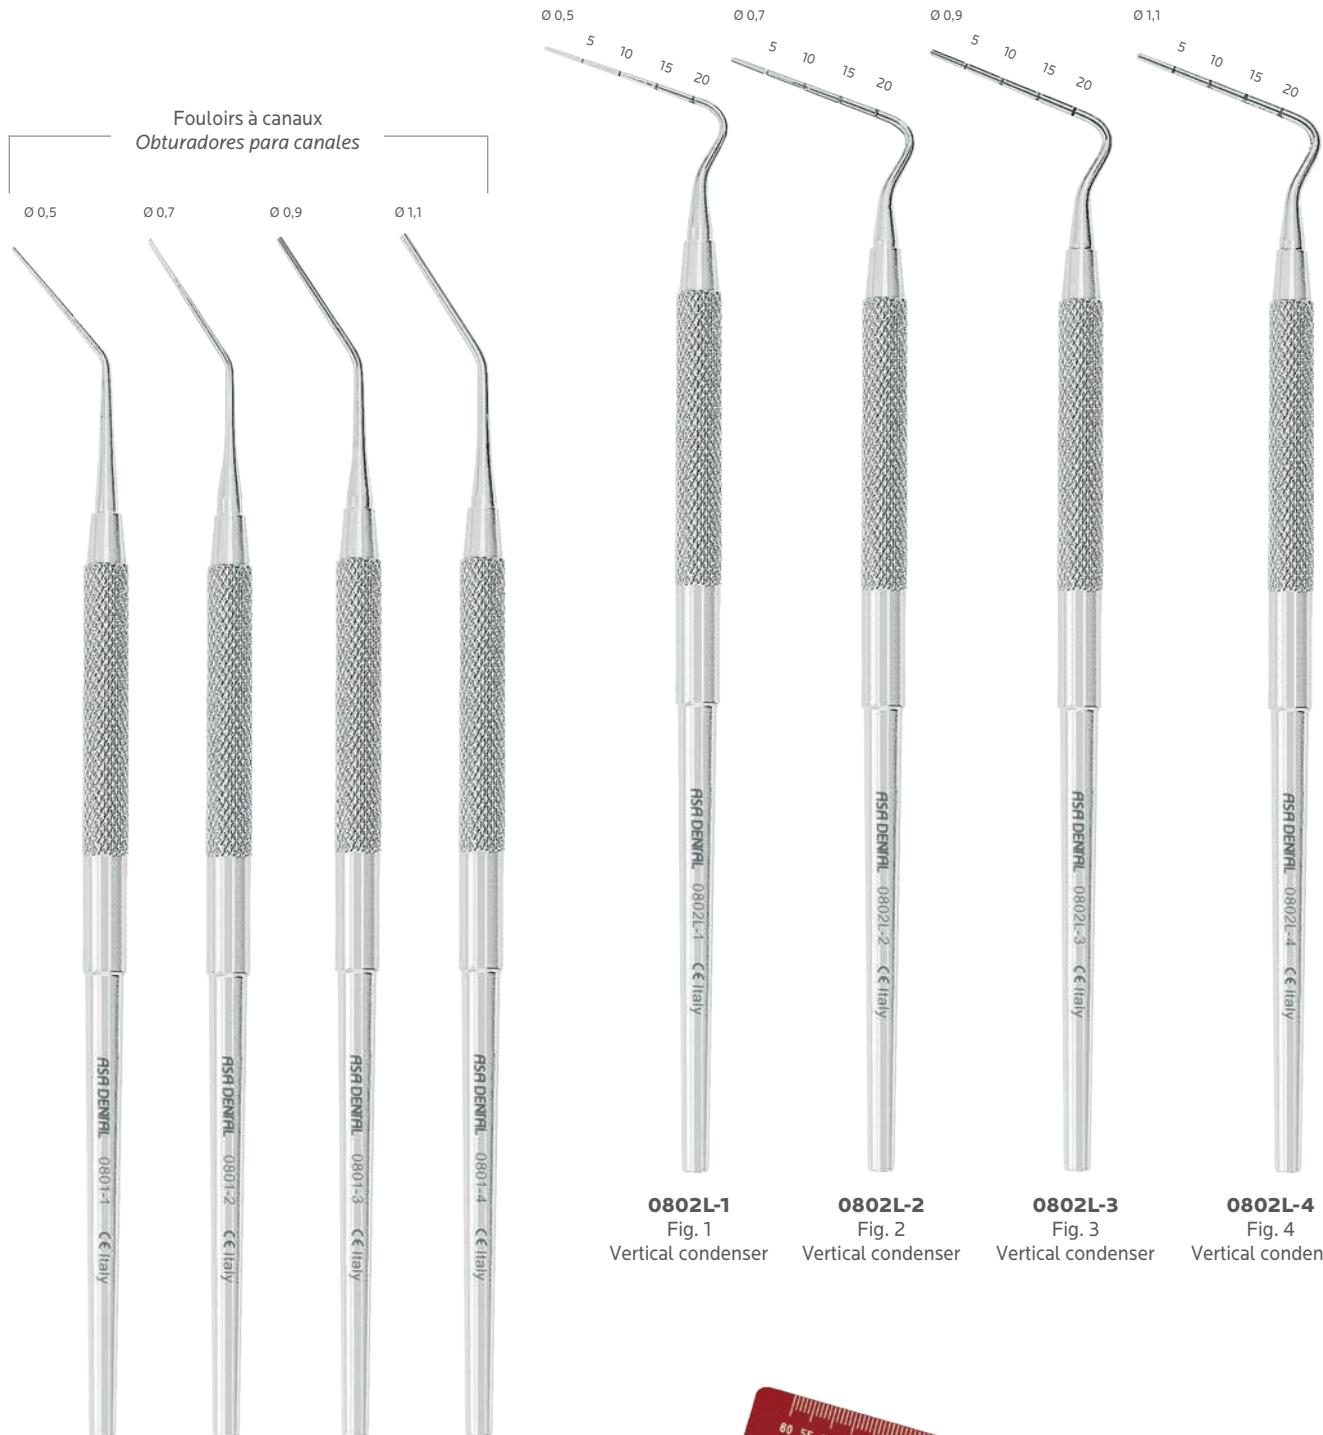

0801-1
Fig. 1
Luks

0801-2
Fig. 2
Luks

0801-3
Fig. 3
Luks

0801-4
Fig. 4
Luks

0802L-1 Fig. 1 Vertical condenser **0802L-2** Fig. 2 Vertical condenser **0802L-3** Fig. 3 Vertical condenser **0802L-4** Fig. 4 Vertical condenser



0800
Plaque millimétrique
Regla calibrada

mesures indicatives
medidas indicativas


Instruments à Endodontie
Instrumentos para EndodonciaFouloirs à canaux
Sondas para canales**0710-6D1**
Fig. 6/1**0710-6D2**
Fig. 6/17**0710-6D3**
Fig. 6/23**1709-32L**
Excavateur à canaux
Excavadore para canalesExcavateurs à canaux
Excavadores para canales**1709-31L**
Fig. 31L**1709-32L**
Fig. 32L**1709-33L**
Fig. 33L

Instruments à Endodontie
Instrumentos para Endodoncia

ASA
LIGHT

Fouloirs à canaux
Sondas para canales

Instruments à Endodontie
Instrumentos para Endodoncia

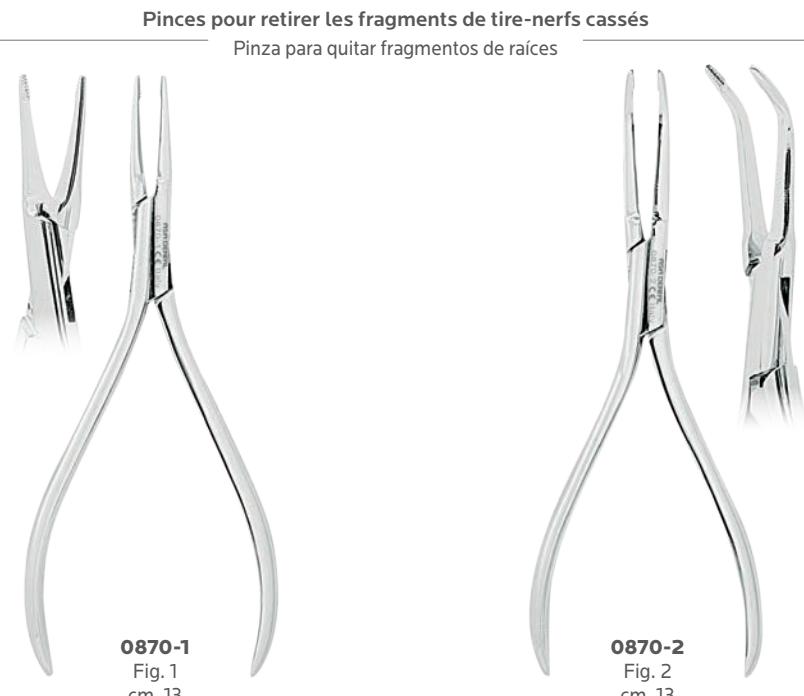

Précelles pour coton
Pinza para algodón y curas



Pince pour cones d'argent
Pinzas para conos de plata



Autofermantes
Con cierre

ASA DENTAL
06022-CE Italy

0602-2
Fig. 2
cm. 15



Coffret pour Endodontie

Juegos para Endodoncia

**S0702L-7**Coffret de 7 sondes millimétriques Laser System
Juego con 7 sondas calibradas Sistema Láser

Contenu/Contenido:

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2702 | Boîte pour instruments complet avec plateau, couvercle et porte-instruments Bandeja y tapa perforadas con porta-instrumentos |
| 0702L-12S | Sondes parodontales graduées O.M.S Sonda calibrada O.M.S. con la punta soldada con Láser |
| 0702L-12 | Sondes calibrées avec la pointe Laser Sonda calibrada con la punta soldada con Láser |
| 0703L-1 | Sondes parodontales graduées Williams Sonda calibrada Williams, Sistema Láser |
| 0703L-4 | Sondes parodontales graduées Goldman-Fox Sonda calibrada Goldman-Fox, Sistema Láser |
| 0706L-2312 | Sondes-explorateurs Sonda combinada/sonda calibrada Fig. 23-CP12, Sistema Láser |
| 0802L-1 | Fouloirs à canaux Fig.1 Obturador para canales Fig.1, Sistema Láser |
| 0802L-2 | Fouloirs à canaux Fig. 2 Obturador para canales Fig 2, Sistema Láser |
| 0800 | Régle graduées Regla calibrada |

**S0702L-23**Coffret de 23 instruments Boston University
Juego con 23 instrumentos Boston University

Contenu/Contenido:

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0601-2 | Précelles pour coton London College Pinza London College para algodón y curas |
| 2101 | Manches pour miroirs à bouche Mango para espejo de boca |
| 2200-4 | Miroir à bouche plan (1) Espejo de boca plano (1) |
| 0800 | Régle graduées Regla calibrada |
| MV0704-23D1 | Explorateurs double Fig. 23/17 Sonda doble Asa Light, Fig. 23/17 |
| MV0710-6D1 | Explorateurs double Fig. 6/1 Sonda doble Asa Light, Fig. 6/1 |

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MV0705-16W | Sondes-explorateurs / Asa Light Williams Fig.16 Sonda combinada/sonda calibrada Asa Light Williams, Fig. 16 |
| MV0705-3GF | Sonde combinée graduées Asa Light Goldman-Fox Fig. 3 Sonda combinada/sonda calibrada Asa Light Goldman-Fox, Fig. 3 |
| 0702L-12S | Sondes parodontales graduées O.M.S Sonda calibrada O.M.S. con la punta soldada con Láser |
| 0702L-12 | Sondes parodontales graduées Sonda calibrada con la punta soldada con Láser |
| 0702L-11 | Sondes parodontales graduées Sonda calibrada con la punta soldada con Láser |
| 0706L-2312 | Sondes-explorateurs Fig.23/CP11 Sonda combinada/sonda calibrada Fig. 23/CP11, Sistema Láser |
| 0706L-2311 | Sondes-explorateurs Fig.23/CP12 Sonda combinada/sonda calibrada Fig. 23/CP12, Sistema Láser |
| 0800-1 | Spreader Fig.1 Spreader Fig. 1 |
| MV1709-32L | Excavateurs à canaux Asa Light Fig. 32L Excavador para canales Asa Light Fig. 32L |
| MV1706-19 | Excavateurs Asa Light Fig. 19 Excavador doble Asa Light Fig. 19 |
| MV1703-14 | Excavateurs Asa Light Fig. 14 Excavador doble Asa Light Fig. 14 |
| MV1701-1 | Excavateurs Asa Light Fig. 1 Excavador doble Asa Light Fig. 1 |
| MV1807-02 | Curette Gracey Asa Light Fig. 1/2 Cureta Gracey Asa Light Fig. 1/2 |
| MV1807-04 | Curette Gracey Asa Light Fig. 3/4 Cureta Gracey Asa Light Fig. 3/4 |
| MV1807-06 | Curette Gracey Asa Light Fig. 5/6 Cureta Gracey Asa Light Fig. 5/6 |
| MV1807-08 | Curette Gracey Asa Light Fig. 7/8 Cureta Gracey Asa Light Fig. 7/8 |
| MV1807-10 | Curette Gracey Asa Light Fig. 9/10 Cureta Gracey Asa Light Fig. 9/10 |
| MV1807-12 | Curette Gracey Asa Light Fig. 11/12 Cureta Gracey Asa Light Fig. 11/12 |
| MV1807-14 | Curette Gracey Asa Light Fig. 13/14 Cureta Gracey Asa Light Fig. 13/14 |
| S2721-2 | Boîte perforée pour instruments Bandeja y tapa perforadas con porta-instrumentos |

**S0800**Coffret d'instruments pour endodontie
Juego de Instrumentos para Endodoncia

Contenu/Contenido:

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2702 | Boîte pour instruments complète et perforée Bandeja y tapa perforadas con porta-instrumentos |
| AL2746-1 | Boîte en aluminium pour le nettoyage des instruments à canaux Caja de aluminio anodizado para instrumentos para canales |
| 0800 | Régle graduées Regla calibrada |
| 0601-2 | Précelles pour coton London College Pinza London College para algodón y curas |
| 2101 | Manches pour miroirs à bouche Mango redondo para espejo de boca |
| 2200-4 | Miroir à bouche plan (1) Espejo de boca plano (1) |
| 0710-6D1 | Explorateurs double Fig. 6/1 Sonda para canales Fig. 6/1 |
| 1709-31L | Excavateurs à canaux Fig. 31L Excavador para canales Fig. 31L |
| 0800-1 | Spreader Fig. 1 Spreader Fig. 1 |

Diagnostique Diagnóstico

Manches de Miroirs à Bouche

Mangos para Espejos de Boca



S2100

Set de 5 pièces

Juego con 5 unidades

Miroirs à Bouche

Espejos de Boca

Boîte de 12 pièces
Caja de 12 unidades



Miroirs à bouche
Rhodium, plan
Espejos de boca
Rhodium, plano



S2101

Set de 5 pièces

Juego con 5 unidades

2200E-6

Fig. 6
Ø 26 mm

2200E-5

Fig. 5
Ø 24 mm

2200E-4

Fig. 4
Ø 22 mm

2220E-4

Fig. 4
Rhodium
Ø 22 mm

Concave
Cóncavos



S2102-IN

Set de 5 pièces

Juego con 5 unidades

2201E-6

Fig. 6
Ø 26 mm

2201E-5

Fig. 5
Ø 24 mm

2201E-4

Fig. 4
Ø 22 mm

2220E-5

Fig. 5
Rhodium
Ø 24 mm



Creux, inoxydable
Hueco, de acero inoxidable



Manches de Miroirs à Bouche - Miroirs à Bouche

Mangos y Espejos de Boca

Manche pour miroir

Mangos para espejos de boca

LEONARDO

ML2101

Aluminium
Aluminio**ASA CODICOLOR**
2002-6
Miroir parallélisateur
Espejo calibrado

S2002-6
Miroir parallélisateur
+ manche cod. 2101
Espejo calibrado y
mango cod. 2101

A cone-socket
Modelo Americano


ASA DENTAL S2002-6 CE Italy

ASA DENTAL 2102-CS CE Italy

2100-CS Cone-socket **2101-CS** Cone-socket **2102-CS** Cone-socket
A cone-socket
Con cone-socketBoîte de 12 pièces
Caja de 12 unidades

Kit Instruments Première Visite

Juegos de Instrumentos para Primera Visita



S0600-6

Contenu/Contenido:

- 0601-2 Précelles pour coton London College
Pinza London College para algodón y curas
- 2101 Manche pour miroirs à bouche
Mango para espejos de boca
- 2200-4 Miroir à bouche plan Fig.4
Espejo de boca plano Fig. 4
- 0700-6 Explorateurs Fig. 6
Sonda con mango anatómico Fig. 6

S0600-9

Contenu/Contenido:

- 0601-2 Précelles pour coton London College
Pinza London College para algodón y curas
- 2101 Manche pour miroirs à bouche
Mango para espejos de boca
- 2200-4 Miroir à bouche plan Fig.4
Espejo de boca plano Fig. 4
- 0700-9 Explorateurs Fig. 9
Sonda con mango anatómico Fig. 9



S0600-23

Contenu/Contenido:

- 0601-2 Précelles pour coton London College
Pinza London College para algodón y curas
- 2101 Manche pour miroirs à bouche
Mango para espejos de boca
- 2200-4 Miroir à bouche plan Fig.4
Espejo de boca plano Fig. 4
- 0700-23 Explorateurs Fig. 23
Sonda con mango anatómico Fig. 23



S0600-1

Contenu/Contenido:

- S2702 Boîte perforée avec porte instruments
Bandeja y tapa perforadas con porta-instrumentos
- 2102-IN Manche pour miroirs à bouche
Mango para espejos de boca
- 2200-4 Miroir à bouche plan Fig.4
Espejo de boca plano Fig. 4
- 0704-23D1 Explorateurs double Fig. 23/17
Sonda doble, Fig. 23/17
- 0708-1N Sondes parodontales Nabers Fig. 1N
Sonda para periodoncia, Fig. 1N
- 0702L-12 Sondes parodontales graduées
Sonda calibrada para periodoncia
- 0601-2 Précelles pour coton London College
Pinza London College para algodón y curas

Miroirs en titainium
Espejos de titanio




Miroirs doubles
Espejos doble




Boîte de 6 pièces
Caja de 6 unidades



Micro miroirs
Espejos micro

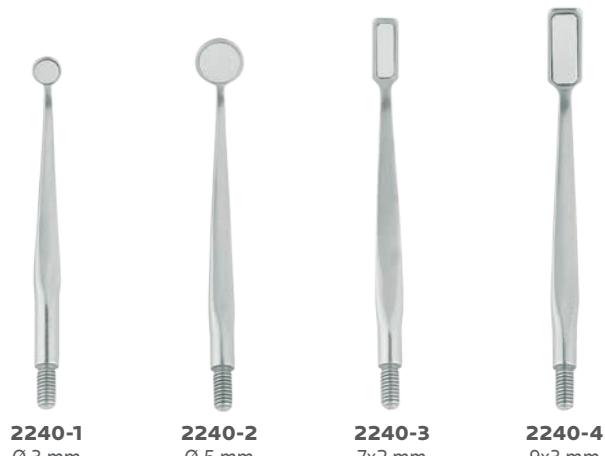

Miroirs photo
Espejos para fotos

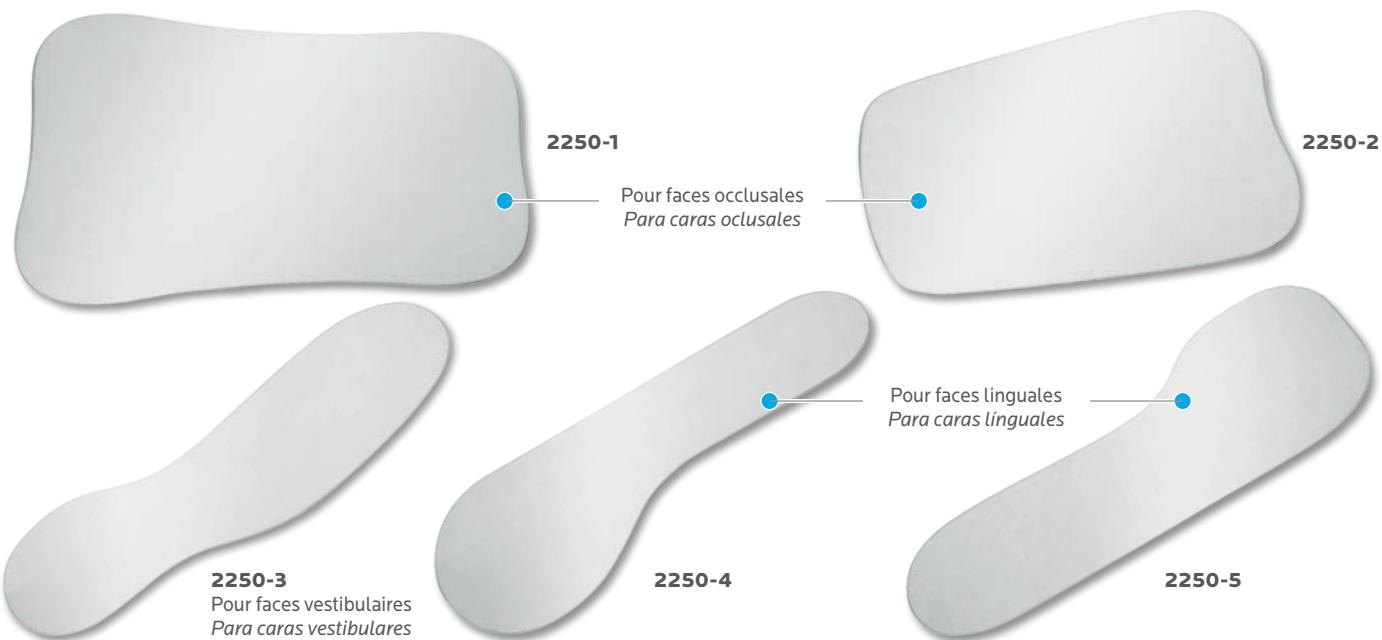

Diagnostique Diagnóstico

Ultralight Mirror et Retractor

Ultralight Mirror y Retractor

Ultralight Mirror



Pièces/Regiones

- 0690-G** joint/garnecido
- 0690-L** lampe/lampara
- 0690-M** ressort/resorte
- 0690-T** tête/cabo

Donées Techniques/Dates tecnicos:

Ampoule Philips shock proof
miniature 2,25 V – 0,25 A
2 piles alcaline type AAA 1,5 V
*Lampara Philips miniatura irremplible
potencia 2,25 V – 0,25 A
2 baterias tipo AAA de 1,5 V alcalinas*

0690
cm. 16



Introduire 2 batteries
Introducir 2 pilas

Enlever les batteries avant la stérilisation
Quitar las pilas antes de la esterilización

Lampe munie d'un joint torique sterilisable qui évite l'introduction de salive ou liquide à l'intérieur du manche et préserve la batterie

*El garnecido interno de la lampara evita la infiltracion
de la saliva o liquido en general en el interior
del mango preservandoasi la integridad de la bateria*

Contact arret/marche facile depuis le bouchon de la lampe
Facilidad de on/off con el boton posterior

Aucune maintenance requise pour
les pièces électriques ou mécaniques
*No es necesario ningun mantenimiento
de las partes electricas o mecanicas*

Entièrement démontable pour un nettoyage parfait
Completamente desmontable para una correcta limpieza

Pampe et piles faciles à changer
Cambio facil de lampara e bateria

Manche ergonomic
Mango ergonomico

Ultralight Retractor



Donées Techniques/Dates tecnicos:

Ampoule Philips shock proof
miniature 2,25 V – 0,25 A
2 piles alcaline type AAA 1,5 V
*Lampara Philips miniatura irremplible
potencia 2,25 V – 0,25 A
2 baterias tipo AAA de 1,5 V alcalinas*

0691
cm. 15



S0690-2

Kit Ultralight avec mirror et
retractor in locking tray mini
*Kit Ultralight con espejo y
retractor en locking tray mini*

Contenu/Contenido:

- 0690 Ultralight Mirror
- 0691 Ultralight Retractor
- 2772-1 Locking Tray -Mini-



SIÈGE SOCIAL DOMICILIO SOCIAL:

Asa Dental S.p.A. uninominale

Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano - 55054 Massarosa (Lu) - Italy
Tel. +39 0584 938305 - 93363 - 938306
Fax +39 0584 937167
asadental@asadental.it
www.asadental.it - www.asadental.com

UNITÉS DE PRODUCTION OPERATIVE OPERATIVE UNITS:

Via Sarzanese Valdera, 1331 - Bozzano - 55054 Massarosa
Lucca - Italy

USINES DE PRODUCTION PLANTAS DE PRODUCCIÓN:

Via delle Piagge, 1/A - Marlia - 55014 Capannori
Lucca - Italy

Via Fierla, 13 - Z.I. - 33085 Maniago
Pordenone - Italy

SIÈGE AUX U.S.A. SEDE EE.UU:

Asa Dental USA Corp.

131 Jericho Turnpike, Suite 202
Jericho - New York 11753 - USA

SIÈGE EN CHINE SEDE CHINA:

Asa Dental CHINA CO., LTD

Room 315, Huaying Building,
Zhong xin Avenue
Tianjin Airport Economic Area
Tianjin - China



ASA DENTAL

MAKE PEOPLE SMILE

